

東日本震災から学ぶ 実験室での地震への備え



東北大学
ナノテク融合技術支援センター 超微細加工部
マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ

1

東北大学のMEMS研究施設



東北大学 青葉山キャンパス



マイクロマシニング研究教育センター (MNC)




西澤記念研究センター(試作コインランドリ)
(4/6インチMEMSライン)



機械系内実験室(20 mm 角ライン)

2


MNC クリーンルーム

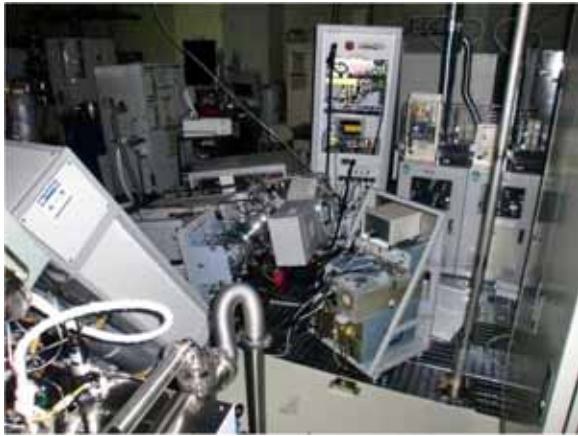

横倒しとなったDRIE装置



周辺装置が横倒しになり、真空ポンプや真空配管が破損した別のDRIE装置

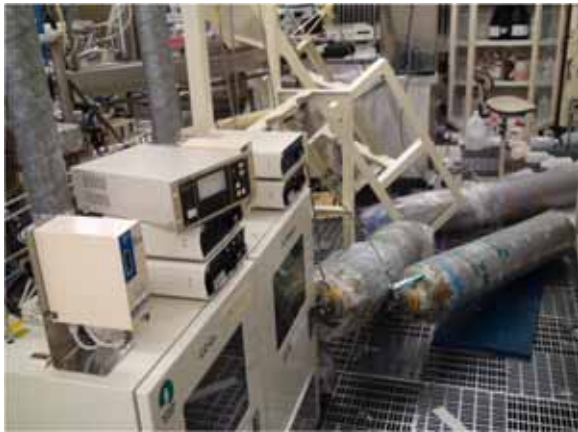


鎖が外れ、横倒しになった47Lポンベ

3

横倒しになったDRIE装置



装置にL字金具をねじ留めせず、平行移動防止を図った結果。

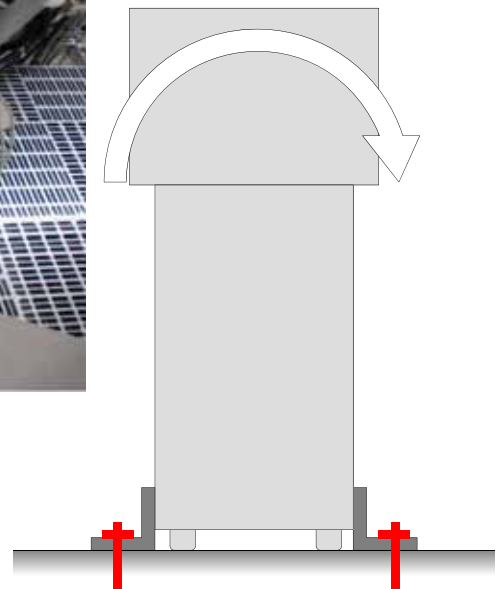

4

装置固定法の一例



高周波電源に穴をあけるのが困難であったため、L字金具で平行移動を阻止。重心の低い装置で、べた置きのものには有効。→
(比較的揺れの小さかった西澤センター 2階スーパークリーンルーム内)

5

ポンベスタンドへの鎖の固定法



地震で開いたリング

対策後のフック

6

転倒・傾斜した装置



←制御装置と一緒に外れたグレーティング(金属スノコ)

↑大きく移動して隣の装置と衝突し、さらに制御ラックが転倒した成膜装置、制御ラックは隣の装置に食い込む。

制御ラックが転倒し、隣の装置に寄りかかる。

(2011年4月7日の余震後)

7

震災後の装置固定方法の一例




装置をグレーティングとその下の鉄骨の両方に固定。長ボルトは、グレーティングの裏表、鉄骨に渡したアングル材の裏表でねじ留め。グレーティングには力分散板を取り付け。



8

装置固定法の一例

(比較的揺れの小さかった西澤センター 2階スーパークリーンルーム内)

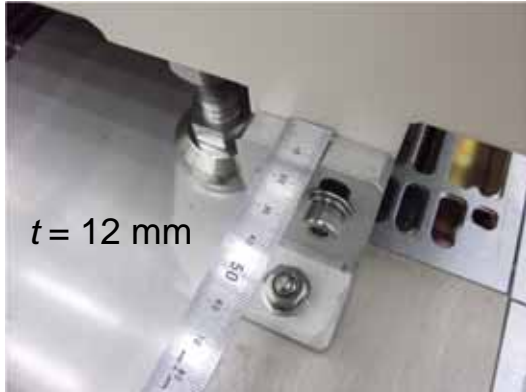

9 重い装置はできるだけ厚い金具で固定。




建屋の梁 (H鋼) を跨ぐようにアングル材を渡し、そこにボルトで固定。

机や装置の上に載っている物品

机から落下した測定器類, 転倒した薬品庫



10 接合装置のディスプレイが精密治具 (ウェハ固定ステージ) 上に落下。

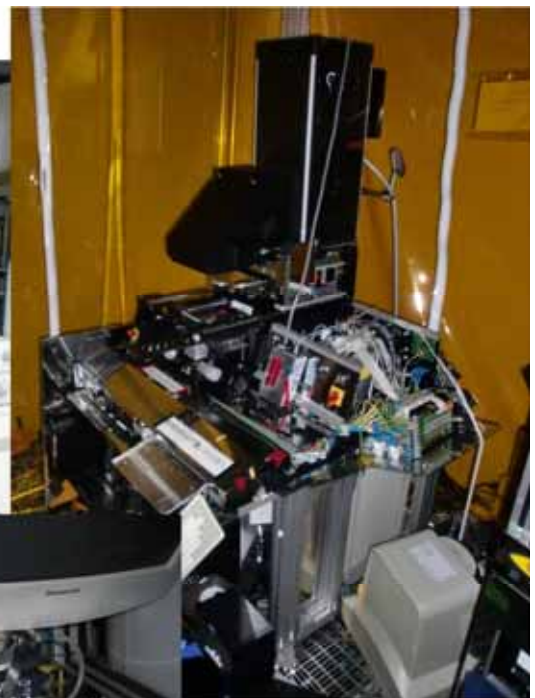

ディスプレイと一緒に崩れ落ちた露光装置

クリーンルームの屋上施設



11 支柱が破損し、歪んだ冷温水パイプ

支持しているダンパが破損し、移動・故障した空冷チラー

建物周辺



陥没したMNC外周のアスファルト



陥没した建物外周のアスファルト
(2011.6.28)



(2011.4.21)




(2011.4.8)



(2011.3.16)

西澤潤一記念研究センター(旧半導体研究所)

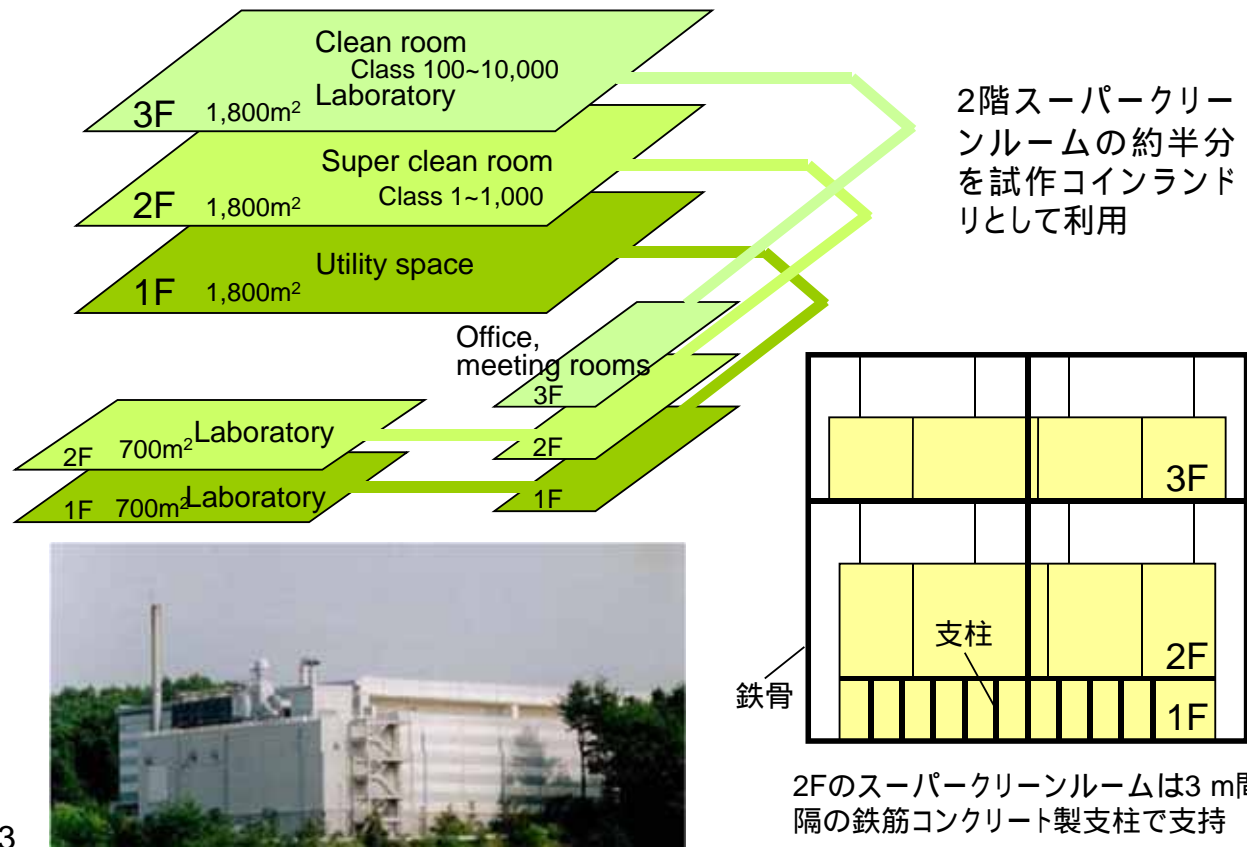

13

西澤センター 2階 スーパークリーンルーム



重心の高い装置は転倒。

14

西澤センター 3階 クリーンルーム



装置が移動。天井と柱との間が割れ、また、多くの内壁が崩れ落ち、石膏ボードの破片・粉末が大量に飛散。

Siエピ成長炉の四塩化ケイ素入りガラス容器が破損し、四塩化ケイ素が約5L飛散。塩化水素ガスが発生し、周囲の金属部品が腐食。

15



西澤センター 3階 クリーンルーム



天井と柱との間が割れ、また、多くの内壁が崩れ落ち、石膏ボードの破片・粉末が大量に飛散。

16





17

天井が揺すられ、曲がった吊りボルト。横方向に渡した揺れ止めがない。



↓ドラフト裏のフッ酸排出パイプ



パイプが破断した冷却塔内部



ドラフトの排気ダクト

18



- 重心の高い装置は転倒する可能性が大きいので、下部に重量物を置くなどバランスを取るべき。
- 重心の高い装置の周囲をL字金具等で囲み、それを装置にボルト留めせず、装置が平行移動しないようにするのは、最悪。装置が倒れる。
- グレーティング上の装置はできるだけ梁などの建屋構造体に固定した方がよい。グレーティングやフリーアクセスの床板に固定する場合は固定箇所を十分多くすべき。
- グレーチングのフィンに局所的に力がかかると、フィンが折れる。複数のグレーチングに力が分散するようにして、転倒防止をする。
- L金具を用いる場合は、十分な厚さのものを選ぶ。金具の取り付け幅が小さい場合、特に厚くする。
- 排気、給排水のラインに使う硬質の塩ビ配管は破断しやすい。ジョイント部分を蛇腹や軟質の配管にすると緩衝の効果がある。
- クリーンルームの天井パネルは上から吊るされている構造でゆれに弱い。横方向の補強（揺れ止め）を行うべき。
- ボンベ立てのチェーンがボンベ立てにリングでかshめてある場合、リングが強い地震で広がってチェーンが外れ、ボンベが倒れる。リングをより強力なフックに変更すべき。
- 机上の装置は、制振ジェル(Pro7という商品名)で固定するべき。
- 金属薄板でできた棚に重量物をしまわない。棚が壊れる。
- 外国製の装置には、地震に弱いものがある。
- 同じ敷地内でも土地、建物で揺れが大きく異なる。
- 19 • 日頃の備えが重要。愛校心(愛社心)も重要。